

ZL45-01

技术服务信息公开登记表

用人单位名称	菏泽市牡丹区伴侣宠物门诊店		
用人单位地址	山东省菏泽市牡丹北城街道八一路成盛新都汇1号楼2单元01010室		
用人单位联系人	秦凯		
公示信息类别	<input type="checkbox"/> 定期检测 <input checked="" type="checkbox"/> 验收检测 <input type="checkbox"/> 现状检测	<input type="checkbox"/> 职业病危害预评价 <input type="checkbox"/> 职业病防护设施设计 <input type="checkbox"/> 控制效果评价与职业病防护设施验收	<input type="checkbox"/> 现状评价
报告编号及项目名称	中威辐检(ZY)字2024第0009号,1台动物DR		
项目组人员名单	展琳琳、孟俊青、高子栋、田士龙、王如如		
现场调查时间	2024年08月28日		
现场调查人员	高子栋、田士龙	用人单位陪同人员	秦凯
采样、检测时间	2024年08月28日		
采样、检测人员	高子栋、田士龙	用人单位陪同人员	秦凯
现场照片			
现场调查图像影像			
 <p>时间: 2024.08.28 14:00 地点: 菏泽市·伴侣宠物诊所 经纬度: 35°15'1"N, 115°27'3"E</p> <p>今日水印 相机真实时间 型号: C4CCL1R3UBE3BD</p>			


现场采样、检测图像影像





时间: 2024.08.28 14:03
地点: 菏泽市·伴侣宠物诊所
经纬度: 35°14'59"N,115°27'3"E

今日水印
相机 真实时间
防伪 E1M9U2H69B6WV

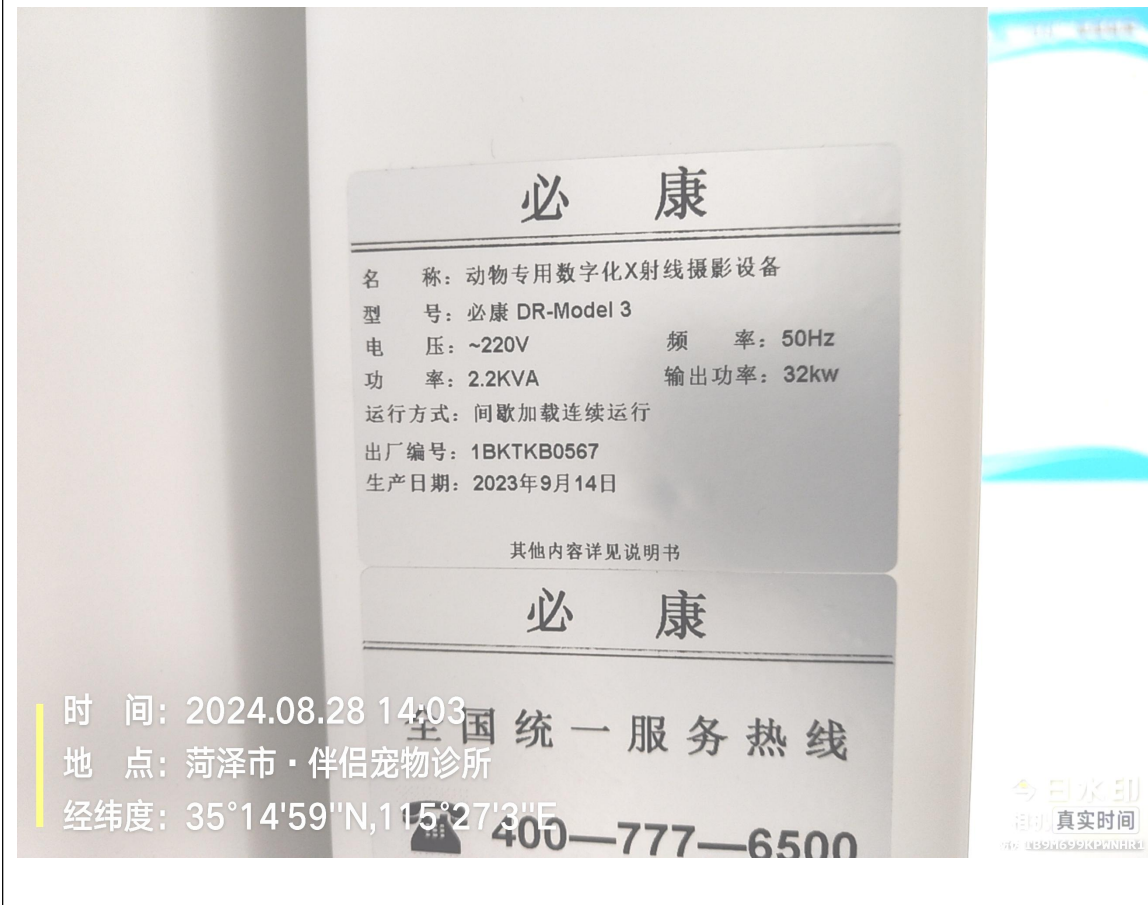

名称: 动物专用数字化X射线摄影设备
型号: 必康 DR-Model 3
电压: ~220V 频率: 50Hz
功率: 2.2KVA 输出功率: 32kw
运行方式: 间歇加载连续运行
出厂编号: 1BKTKB0567
生产日期: 2023年9月14日
其他内容详见说明书
全国统一服务热线
400-777-6500

今日水印
相机 真实时间
防伪 0B3M699KPNRRE1

备注: 预评价、防护设施设计如有类比资料则只填写现场调查部分。